

Анализатор проницаемости кислорода Y110L (кулонометрический датчик)



Описание

Анализатор Y110L основан на принципе тестирования с помощью кулонометрического датчика кислорода и разработан, и изготовлен с учетом стандартов GB/T 19789, ASTM D3985 и других стандартов. Благодаря использованию высокоточного импортного датчика кислорода этот тестер имеет высокую точность испытаний. Он подходит для испытания пленок, листов, бумаги, упаковок и сопутствующих материалов на проницаемость кислорода в области продуктов питания, медицины, медицинского оборудования, бытовой химии, фотоэлектрической электроники и т. д. Он обеспечивает высокоэффективное определение скорости пропускания кислорода для широкого спектра материалов с высокими, средними и низкими барьерными свойствами.

Принцип измерения

Анализатор проницаемости кислорода Y110L основан на принципе метода кулонометрического датчика. Предварительно обработанный образец закрепляется в середине испытательной камеры, в верхнюю камеру пленки течет кислород высокой чистоты, в нижнюю камеру течет азот высокой чистоты (газ-носитель). Молекулы кислорода диффундируют через пленку в азот на другой стороне и переносятся к датчику потоком азота. Скорость передачи кислорода рассчитывается путем анализа концентрации кислорода, измеренной датчиком.

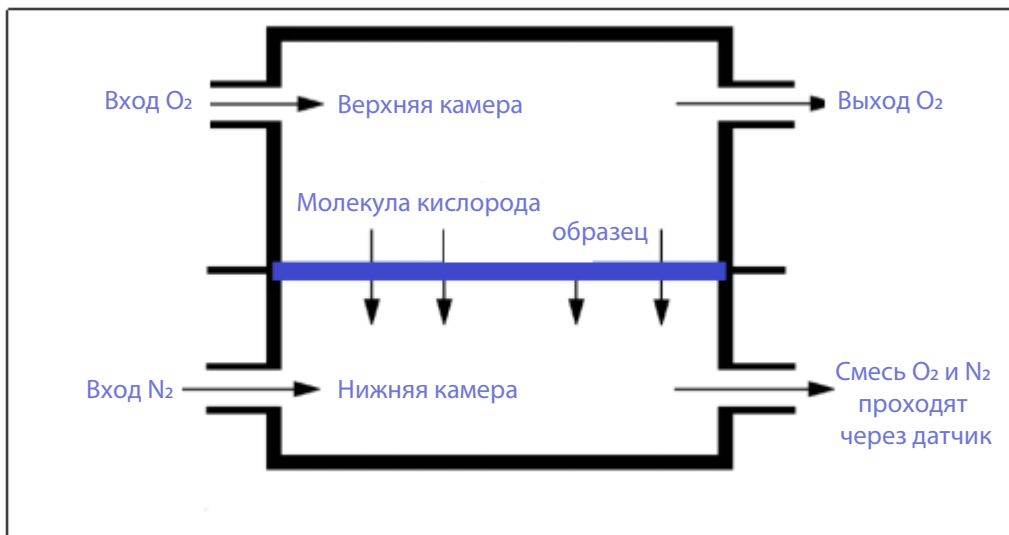


Схема метода кулонометрического датчика

Стандарты

ASTM D3985, ASTM F2622, ASTM F1927, ASTM F1037, ISO 15105-2, JIS K-7126-B, DIN 53380-3, GB/T 19789, YBB 00082003

Технические характеристики

Наименование	Параметр
Диапазон тестирования	0.05~1000 см ³ /(м ² ·24ч·0.1МПа), (до 260000 см ³ /(м ² ·24ч·0.1МПа) можно измерить с помощью зажима)
Разрешение	0.0001 см ³ /(м ² ·24ч·0.1 МПа)
Температурный диапазон	15~45°C
Температурная точность	±0.2°C
Диапазон влажности	0%RH, 5~90%RH, 100%RH
Точность влажности	±2%RH
Площадь тестирования	50.24 см ² (с кастомными аксессуарами, минимум до 0.785 см ²)
Размер образца	Ø100 мм
Толщина образца	≤3 мм
Количество образцов	1 шт.
Давление газа-носителя	≥0.1 МПа
Расход газа-носителя	5-100 мл/мин
Размеры прибора	440 мм×680мм×380 мм
Мощность	450 Вт
Параметры питания	220 В переменного тока, 50 Гц



Особенности

Запатентованная базовая технология, эффективное и точное тестирование

Высокоточный импортный датчик кислорода с высокой чувствительностью, высокой стабильностью и низкой интенсивностью отказов, с разрешением $0.0001 \text{ см}^3/(\text{м}^2 \cdot 24 \text{ ч} \cdot 0,1 \text{ МПа})$.

Автоматический точный контроль температуры и влажности.

Точный контроль температуры и влажности теста. Температура и влажность в испытательной камере стабильны благодаря оснащению высокоточными датчиком температуры и влажности, точность контроля температуры может достигать $0.2 \text{ }^\circ\text{C}$, а влажность может быть достигнута с точностью до $\pm 2\%$ относительной влажности. Автоматический режим испытаний, мониторинг в реальном времени температуры, влажности, значений и кривых расхода газа в процессе испытания, высокая воспроизводимость испытаний.

Удовлетворение потребностей в высокопроизводительном и широком диапазоне испытаний

Анализатор оснащен одной небольшой и гибкой камерой.

Сверхширокий диапазон испытаний [$0.05 \sim 1000 \text{ см}^3/(\text{м}^2 \cdot 24 \text{ ч} \cdot 0.1 \text{ МПа})$] соответствует требованиям испытаний материалов с высокими, средними и низкими барьерными свойствами. С добавлением аксессуаров-адаптеров можно измерять скорость передачи кислорода в бутылках, пакетах, мисках и других контейнерах.

Интеллектуальная операционная система, глобальная сертификация

Интеллектуальная операционная система собственной разработки, модульная графика, гибкая настройка параметров процесса испытаний, интуитивно понятное и удобное управление.

Разработанный в соответствии с приложением GMP «Компьютеризированная система», анализатор имеет функцию контрольного журнала и многоуровневые настройки полномочий для пользователей, которые могут удовлетворить потребности фармацевтической промышленности в отслеживании данных.






Персонализированные отчеты испытаний могут быть настроены по требованию, поддерживаются формы вывода данных в нескольких форматах.



Профессиональная калибровка, точные и надежные данные

Наша компания имеет «Национальный стандартный сертификат классификации веществ», одобренный и выданный «Главным управлением по надзору за качеством, инспекцией и карантинном Китайской Народной Республики», номер эталонного материала (GBW (E) 130497 / GBW (E) 130498); Национальный эталонный материал используется для калибровки и тестирования прибора, чтобы гарантировать точность, универсальность и достоверность данных испытаний.

Область применения

	<p>Пленки</p>	<p>Испытание на скорость проницаемости кислорода различных пластиковых пленок (PP/PET/PE/PVC/VOPP/СPP и т. д.), пластиковых композитных пленок, бумажно-пластиковых композитных пленок, металлических композитных пленок, коэкструзионных пленок, алюминизированных пленок, разлагаемых упаковочных пленок. (PLA/PBAT/PBS и т. д.) и другие пленкоподобные материалы.</p>
	<p>Листовые материалы</p>	<p>Испытание скорости проницаемости кислорода твердых фармацевтических твердых листов (ПП/ПВХ/ПТП и т. д.), металлических композитных листов, резиновых листов и пр.</p>
	<p>Бумага, картон и их композиты</p>	<p>Испытание скорости проницаемости кислорода для мелованной бумаги, силиконовой бумаги, алюминизированной бумаги для сигаретных пакетов, бумажных композитных листов из алюминия и пластика и другой бумаги и картона.</p>
	<p>Лекарственные пластыри</p>	<p>Испытание медицинских пластырей на скорость проницаемости кислорода.</p>
	<p>Продукты гигиены</p>	<p>Испытание скорости проницаемости кислорода для гигиенических изделий, таких как гигиенические салфетки и ежедневные прокладки.</p>

	<p>Упаковочные материалы</p>	<p>Бутылки для вина, бутылки из-под кока-колы, бочки для арахисового масла, упаковка Tetra Pak, пакеты для вакуумной упаковки, трехкомпонентные банки, косметическая упаковка, тюбики для зубной пасты, стаканчики для желе, стаканчики для йогурта и т. д. Пластик, резина, бумага, бумажно-пластмассовый композит, стекло, металлические бутылки. Испытание на скорость проницаемости кислорода мешков, банок, коробок и бочек.</p>
	<p>Крышки для упаковок</p>	<p>Испытание характеристик проницаемости кислорода для различных крышек для упаковок</p>
	<p>Задняя панель солнечной батареи</p>	<p>Испытание производительности проницаемости кислорода задней панели солнечной батареи.</p>
	<p>Трубы</p>	<p>Проверка проницаемости кислорода для труб из различных материалов</p>

Комплектация

<p>Стандартная конфигурация</p>	<p>Шнур питания, коммуникационный кабель, шаблон для резки образца, уплотнительная смазка, металлическая трубка для воздуха, соединитель ферулла, эталонный образец, шестигранный ключ, шприц, уплотнительное кольцо, вилочный ключ, крестовая отвертка, мышка</p>
---------------------------------	--

<p>Доступно опционально</p>	<p>ПК, сертификат калибровки</p>
<p>Коммуникации, обеспечиваемые стороной Заказчик</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Стандартная лаборатория, 2. Требования к питанию: регулируемый источник питания 220 В, одна розетка. 3. Требования к компьютеру: стандартная конфигурация (Windows 10, с девятиконтактным последовательным портом). 4. Один баллон с кислородом, чистота должна быть выше 99.999%, с редуктором, диапазон выходного давления: 0-0.4 МПа; 5. Один баллон с азотом, чистота должна быть выше 99.999%, с редуктором, диапазон выходного давления: 0-0.4 МПа

Примечание. Компания GBPI всегда стремится к инновациям и улучшению производительности и функциональности продукции. По этой причине технические характеристики и внешний вид продукта могут быть соответствующим образом изменены. О вышеуказанных изменениях не будет уведомлено. Компания оставляет за собой право на внесение изменений и окончательную интерпретацию.



Контакты производителя:

Address: No. 1, Minghua 3rd Street, Jinxiu Road,
Guangzhou Economic and Technological Development Zone

Tel: 0086 20-86153794

After-sales hotline: 4007886855

Website: <https://www.gbpitester.com/>

Email: info@gbtest.cn

Официальный дистрибьютор в РФ

ООО "Промэнерголаб"

105318, Россия, г. Москва, ул. Ткацкая, 1

Тел.: +7 (495) 22-11-208, 8 (800) 23-41-208

e-mail: info@czl.ru

www.czl.ru

